

BỘ Y TẾ  
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC  
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 240/VKNTTW-BHC  
V/v báo giá dịch vụ hiệu chuẩn Bộ  
thiết bị đo nhiệt độ Mesa Lab

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị phân tích

Căn cứ tờ trình về việc thuê dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích ngày 18/03/2024 của Ban hiệu chuẩn thiết bị phân tích.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu hiệu chuẩn các thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Viện, cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
Bộ thiết bị đo nhiệt độ Mesa Lab				
1	Sensor nhiệt độ (MPIII)	- Nhiệt độ hiệu chuẩn: -20; 5; 23; 32; 37; 57; 85; 105 và 122 °C. - Độ phân giải: 0,01°C.	Cái	14
2	Sensor nhiệt & áp suất (MPIII Pressure)	- Nhiệt độ 5; 23; 32; 40; 60; 85; 105; và 122°C. - Áp suất: 0.0; 1.0; 2.0 và 2.5 bar	Cái	03
3	Sensor Nhiệt & ẩm (MPIII Humidity)	- Nhiệt độ 5; 20; 25; 30 và 40°C - Độ ẩm: 10; 30; 40; 60; 70 và 80 %.	Cái	03

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị như trên, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

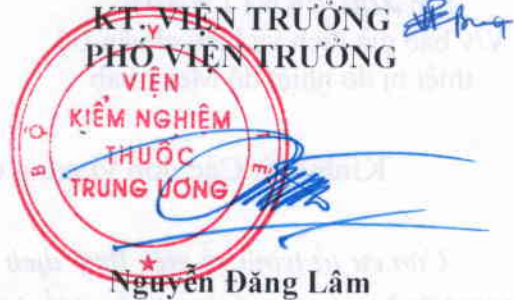
- Giá chào hàng thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VND); giá chào hàng là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các chi phí liên quan khác (nếu có);
- Báo giá phải ghi rõ năng lực thực hiện hiệu chuẩn thiết bị của đơn vị;
- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được đóng dấu niêm phong của đơn vị báo giá và gửi về Ban Hiệu chuẩn thiết bị phân tích - Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước ngày 26/3/2024.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Ban Hiệu chuẩn thiết bị phân tích - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 0914.849.326 - 0911.629.888.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tô CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.


  
**KT. VIỆN TRƯỞNG**
  
**PHÓ VIỆN TRƯỞNG**
  
**VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG**
  
**Nguyễn Đăng Lâm**

Số	Tên phòng ban	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị
1	Phòng nhiệt độ (MHIIT)	Nhiệt độ hiện chuẩn: 20, 25, 30, 37 2, 5, 8, 10 và 12°C Độ phân giải: 0,01°C	CĐ
2	Phòng nhiệt độ độ ẩm (MHIIT)	Nhiệt độ: 2, 25, 30, 40, 60, 82, 105, và 125°C Độ ẩm: 0,1, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 75, 90%	CĐ
3	Phòng nhiệt độ ẩm (MHIIT)	Nhiệt độ: 2, 20, 25, 30 và 40°C Độ ẩm: 10, 20, 40, 60, 70 và 80%	CĐ